

Vejledning om indberetning af implantater til Det Nationale Implantatregister (NIR) for private aktører i perioden 1.07.2018 – 31.10.2018 via MiniPas

Baggrund for indberetning

Se bekendtgørelse nr 1334 af den 27/11/2017 på www.retsinformation.dk

Indberetning

Indberetning af implantater vil altid være betinget af en operation. I forvejen er operationen registreret i MiniPas (se figuren på sidste side i dette dokument). Man kan indberette enten ved manuel indtastning i felterne nederst i MiniPas-skemaet eller ved brug af strekkodeskanner.

Brugervejledning til skanner:

Scannerens basestation har to stik. Det ene stik er til strøm og indsættes i en strømforsyning. Det andet stik er et USB-kabel som sættes i computerens USB-port. Scanneren skal oplades på forhånd og er fuldt opladt når lyset i toppen er grønt. Denne vil lyse rødt under opladning.


For at teste om scanneren virker, kan du fx åbne et tekstdokument på din pc, lade dette dokument være aktivt og samtidigt forsøge på at scanne en tilfældig strekkode. Såfremt data fra strekkoden fremkommer i dokumentet, virker scanneren som den skal.

Oplysninger om implantater, der skal registreres i implantatregisteret, fremgår af produktinformationerne på emballagen i form af en unik strekkode eller QR-kode. Der er udviklet en scanningsfunktion for den mest anvendte strekkodestandard, kaldet GS1. Felterne produkt-/varenummer, Batch-/lot-nummer, Serienummer, Udløbsdato og Produktionsdato indlæses automatisk.

Sådan indberetter du:

Data fra scanningen af implantaternes produktinformationer kan nu indsættes i skemaet med de 8 kolonner:

Det aktuelle skema for implantater i Minipas:

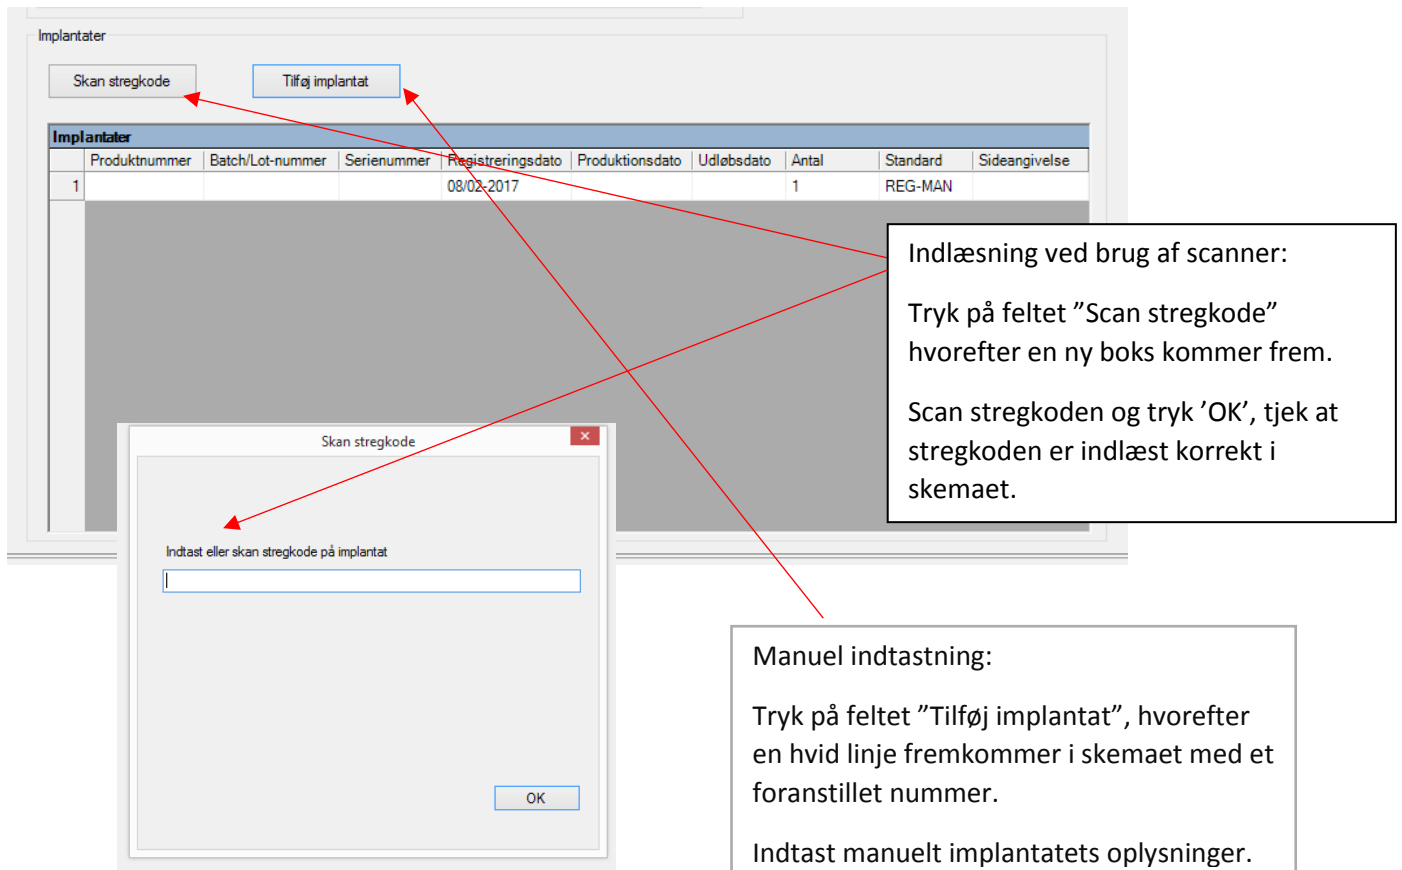

The screenshot shows the 'Implantater' interface with a table and two buttons: 'Skan stregkode' and 'Tilføj implantat'. A dialog box titled 'Skan stregkode' is open, showing a text input field and an 'OK' button. Two text boxes provide instructions for scanning and manual entry.


Produktnummer	Batch/Lot-nummer	Serienummer	Registreringsdato	Produktionsdato	Udløbsdato	Antal	Standard	Sideangivelse
1			08/02-2017			1	REG-MAN	

Indlæsning ved brug af scanner:
Tryk på feltet "Scan stregkode" hvorefter en ny boks kommer frem.
Scan stregkoden og tryk 'OK', tjek at stregkoden er indlæst korrekt i skemaet.

Manuel indtastning:
Tryk på feltet "Tilføj implantat", hvorefter en hvid linje fremkommer i skemaet med et foranstillet nummer.
Indtast manuelt implantatets oplysninger.

SEI-systemet foretager en gennemgående logisk validering inden data kan afsendes til Sundhedsdatastyrelsen.

Minipas skemaet for indberetning af operationer, samt markering af hvor der tilføjes operationer og implantater (se evt. også MiniPas vejledning vedr. operationer):

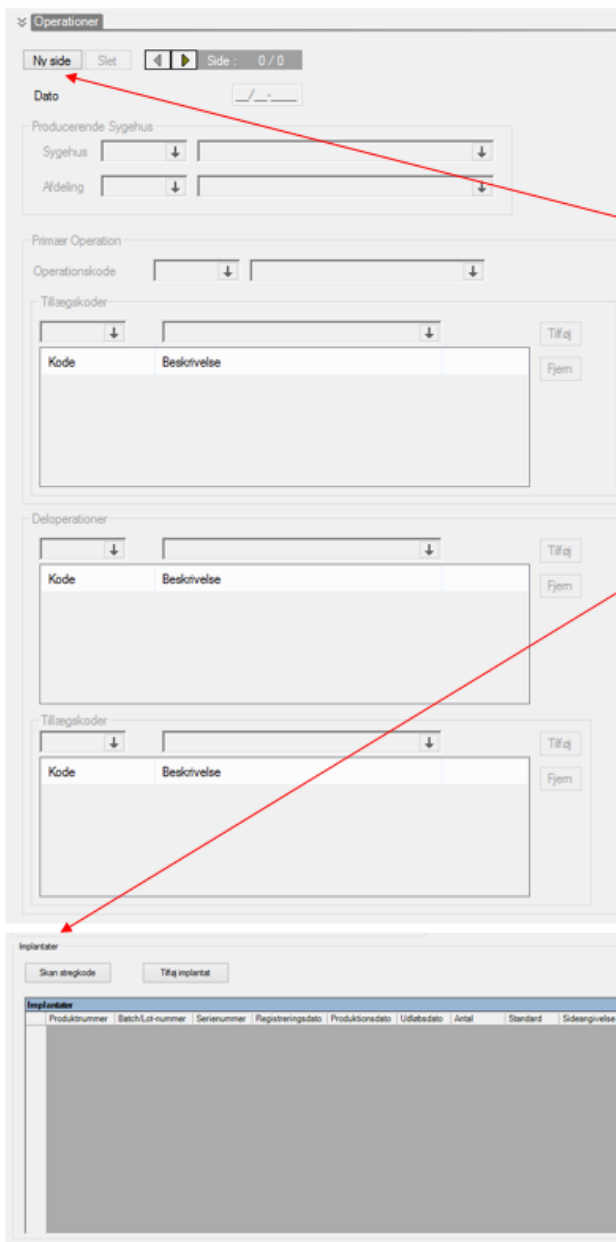

Indberetning af operation:
 Tryk på ny side.
 Indtast de ønskede oplysninger for den gældende operation fj. fællesindholdet.

For den enkelte operation er det muligt at skanne eller manuelt indtaste det/de implantat(er) der er benyttet fj. ovenstående figur.
 Hvis der foretages flere operationer, vælges ny side for hver operationskode og de tilhørende implantater til hver operation indberettes.